

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

Konu: Şeker sribi

SİMAV/KÜTAHYA
07.04.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazılı İdari Şartlarda satın alınacaktır.

İdari Şartlar;

1. Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde 0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gönderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.
2. Teklif mektupları yazılı, ad-soyad ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
3. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariç ya da dâhil olduğu belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
4. Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim süreleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekür/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
6. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.
8. Şartname düzenlenmemiş olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gönderilecektir.
9. İstenildiğinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.
10. İdaremiz alımı yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir.
11. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlerinizin TITUBB Kayıt Numarası, varsa SUT Kodu ve Distribütör firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. Ayrıca Medulaya kayıtlı olduğuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.
12. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç 3(ÜÇ) gün içerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
13. Malzemelerin faturası mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
14. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
15. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
16. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
17. Tekliflerinizi en geç 11.04.2022 günü Saat: 10:00 'a kadar bekler, işlerinizde başarılar dilerim.


Op. Dr. Naç ÇAĞLAR
Başhekim


S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	UBB NO	B. Fiyatı	Toplam
1	ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ	40.000	ADET			
TOPLAM (KDV Hariçtir)						


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Yöneticiliği

ŞEKER STRİBİ KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yüklenici firma hastanemizin talep ettiği miktarda şeker ölçüm cihazlarını striplerin bitiminde iade edilmek şartı ile striplerin kullanımı bitene kadar bedelsiz ilgili birimlere tutanak karşılığı teslim edecektir. En az 50 adet.
- 2- Az miktarda kullanan ünitelerin bulunduğu göz önüne alındığında son kullanma tarihine kadar stabilliğini koruması ve sağlıklı ölçüm yapılabilmesi için her bir stripler ayrı ayrı nemden etkilenmeyen kullanım anına kadar sterilitesi bozulmayacak tekli ambalajda veya son kullanma tarihine kadar yukarıda sayılan özelliklerin korunabileceği 10-25-50 veya 100'lük kutularda içerisindeki stripleri nem gibi dış etkilere koruyan ambalajlarda olmalıdır.
- 3-Ambalaj üzerinde kullanım amacı, saklama koşulları, imal ve son kullanma tarihleri ve Sağlık Bakanlığında onay tarih ve numaraları bulunmalıdır.
- 4-Cihazların TÜRKÇE kullanım kılavuzu ve kalibrasyon aparatları bulunmalıdır. Teknik ve eğitim desteği sağlanmalıdır.
- 5-Kullanım kolaylığı açısından teslim edilen bütün stripler aynı seri ve lot numarasında olmalıdır.
- 6-En az 1 adet cihaz ve bir orijinal kutu strip numunesi olacak) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7- Teslimatta en az 24 ay miatlı olmalı ve üretim/sterilizasyon tarihleri teslim tarihinden geriye doğru 4 (dört) aydan fazla olmamalıdır.
- 8-Cihazlar ve ölçüm sonuçları elektronik cihazlardan ve elektromanyetikli ortamlardan(cep telefonu,radyo,mıknatıs v.b., pil ve akü ile çalışan cihazlardan) etkilenmemelidir ve bu belgelendirilmelidir. Bu madde fiyat eşitliği durumunda tercih sebebi olacaktır
- 9-Stripler doğru ölçüm için yeterli kan alamadığında uyarı vermeli veya bu nedenden ötürü belirli bir süre ölçüm yapmamalıdır.Cihaz 2-2,5 mikro litre kan ile ölçüm yapabilmelidir.
- 10-Geriye dönük en az 100 (yüz) ölçüm ve 30 (otuz) gün hafızasına sahip olmalıdır. Ölçüm süresi 15 saniyeden az olmalıdır.
- 11-Glukoz ölçüm aralığı 20-500 mg/dl aralığından dar olmamalıdır.
- 12-Biyosensör teknolojisi ile çalışmalıdır.
- 13-Her ölçüm öncesi kalibrasyon gerektirmemelidir. Yüklenici firma tarafından 24 saat ücretsiz teknik servis ve gerektiğinde eğitim desteği verilmelidir. Kırılma, bozulma v.b. sebeplerle kullanım dışı kalan cihaz en geç 48 saat içerisinde yenisi ile bedelsiz olarak değiştirilecektir.
- 14-Alternatif bölgelerden ölçüm yapmaya imkan tanımalıdır. Kapiller ve neonatal kanda ölçüm yapabilmeli, Hemotokrit aralığı % 20-70 olmalıdır.
- 15-İlaç kullanıldığı göz önünde tutulduğunda bazı etken maddelerin ve bilirubin,kolesterol gibi etkenlerin kandaki normal düzeylerinin (veya kan konsantrasyonlarının) üzerine çıkacağı açıktır, fiyat eşitliği durumunda cihazlarla yapılan ölçümler neticesinde çıkacak sonuçların üzerine bu etkenleri yansıtmayan, yansıtmayan cihaz olmaz ise en az yansıtan cihazlar tercih edilecektir.

Bu eserde AİDİN



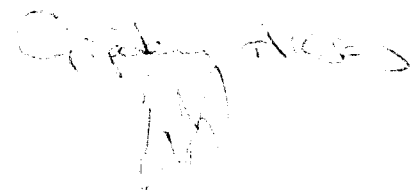


16-Cihazın hassasiyeti hastanemiz laboratuvar deęerleriyle karřılařtırıldığında sonular tutarlı olmalıdır ve bu laboratuvar sonucu referans alınarak En fazla \pm % 5 sapma kabul edilecektir.

17-Cihaz aık kaldığında otomatik kapanmalıdır ve lm sırasında cihaz hareket ettirildiğinde lm sonucu deęiřmemelidir. Kan stribe kolayca ekilebilmelidir, Strip cihaza kolayca yerleřtirilebilmelidir.

18-Cihaz 10-40 Santigrad Derece arasındaki evre ısılarında doęru sonu verebilmelidir, Cihazın bir pil ile en az 1000 lm yapabilmelidir. Yklenici firma cihazlarla beraber yeteri kadar pili bedelsiz vermelidir.

19-Cihazlar kalibre edilmiř olmalıdır ve talep eden birimlerin isteęi halinde kalibrasyon belgeleri verilebilmelidir. Yklenici firma periyodik olarak cihazın doęru lm kontroln yapmalı (en az iki ayda bir)

20-Cihaz st ste 2 ve daha fazla sayıda lm yaptığında lm sonuları arasında tutarlılık olmalı. ( lm ortalamasına gre lmler arasında %5'ten fazla sapma olmamalıdır.)

21-Her strip ambalajı iin cihazı tekrar kalibre etmek gerekmemelidir. Bu madde fiyat eřitlięi durumunda tercih sebebi olacaktır. Her kutuda kalibrasyon ubuęu ıkmalıdır.

22-Glukometre lm sistemlerinin analizleri, bu konuda uluslararası bir standart olan ve TSE tarafından da Trk Standardı olarak kabul edilen EN ISO 15197 kriterlerine uygun olmalı ve ayrıca piyasaya srlme ařamasında cihazın performansını etkilemeyecek depolama kořullarında muhafaza edilmiř olmalıdır.

23-Glukometre cihazlarının rutin kontrolleri iin; kontrolleri alıřan birime (laboratuvar), her ay yeterli miktarda kontrol solsyonları verilmelidir. En az 2 kontrol solsyonu (normal,dřk,yksek) olmalıdır.

Besir AĞDIN
B.A.

Özge Kaya
H.K.

ngelme Zekeriya
Z.